




# Flowchart

ขั้นตอนการขอประเมินเทคโนโลยี

ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย  
การติดเชื้อ SARS-CoV-2  
(เชื้อก่อโรค COVID-19)


ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

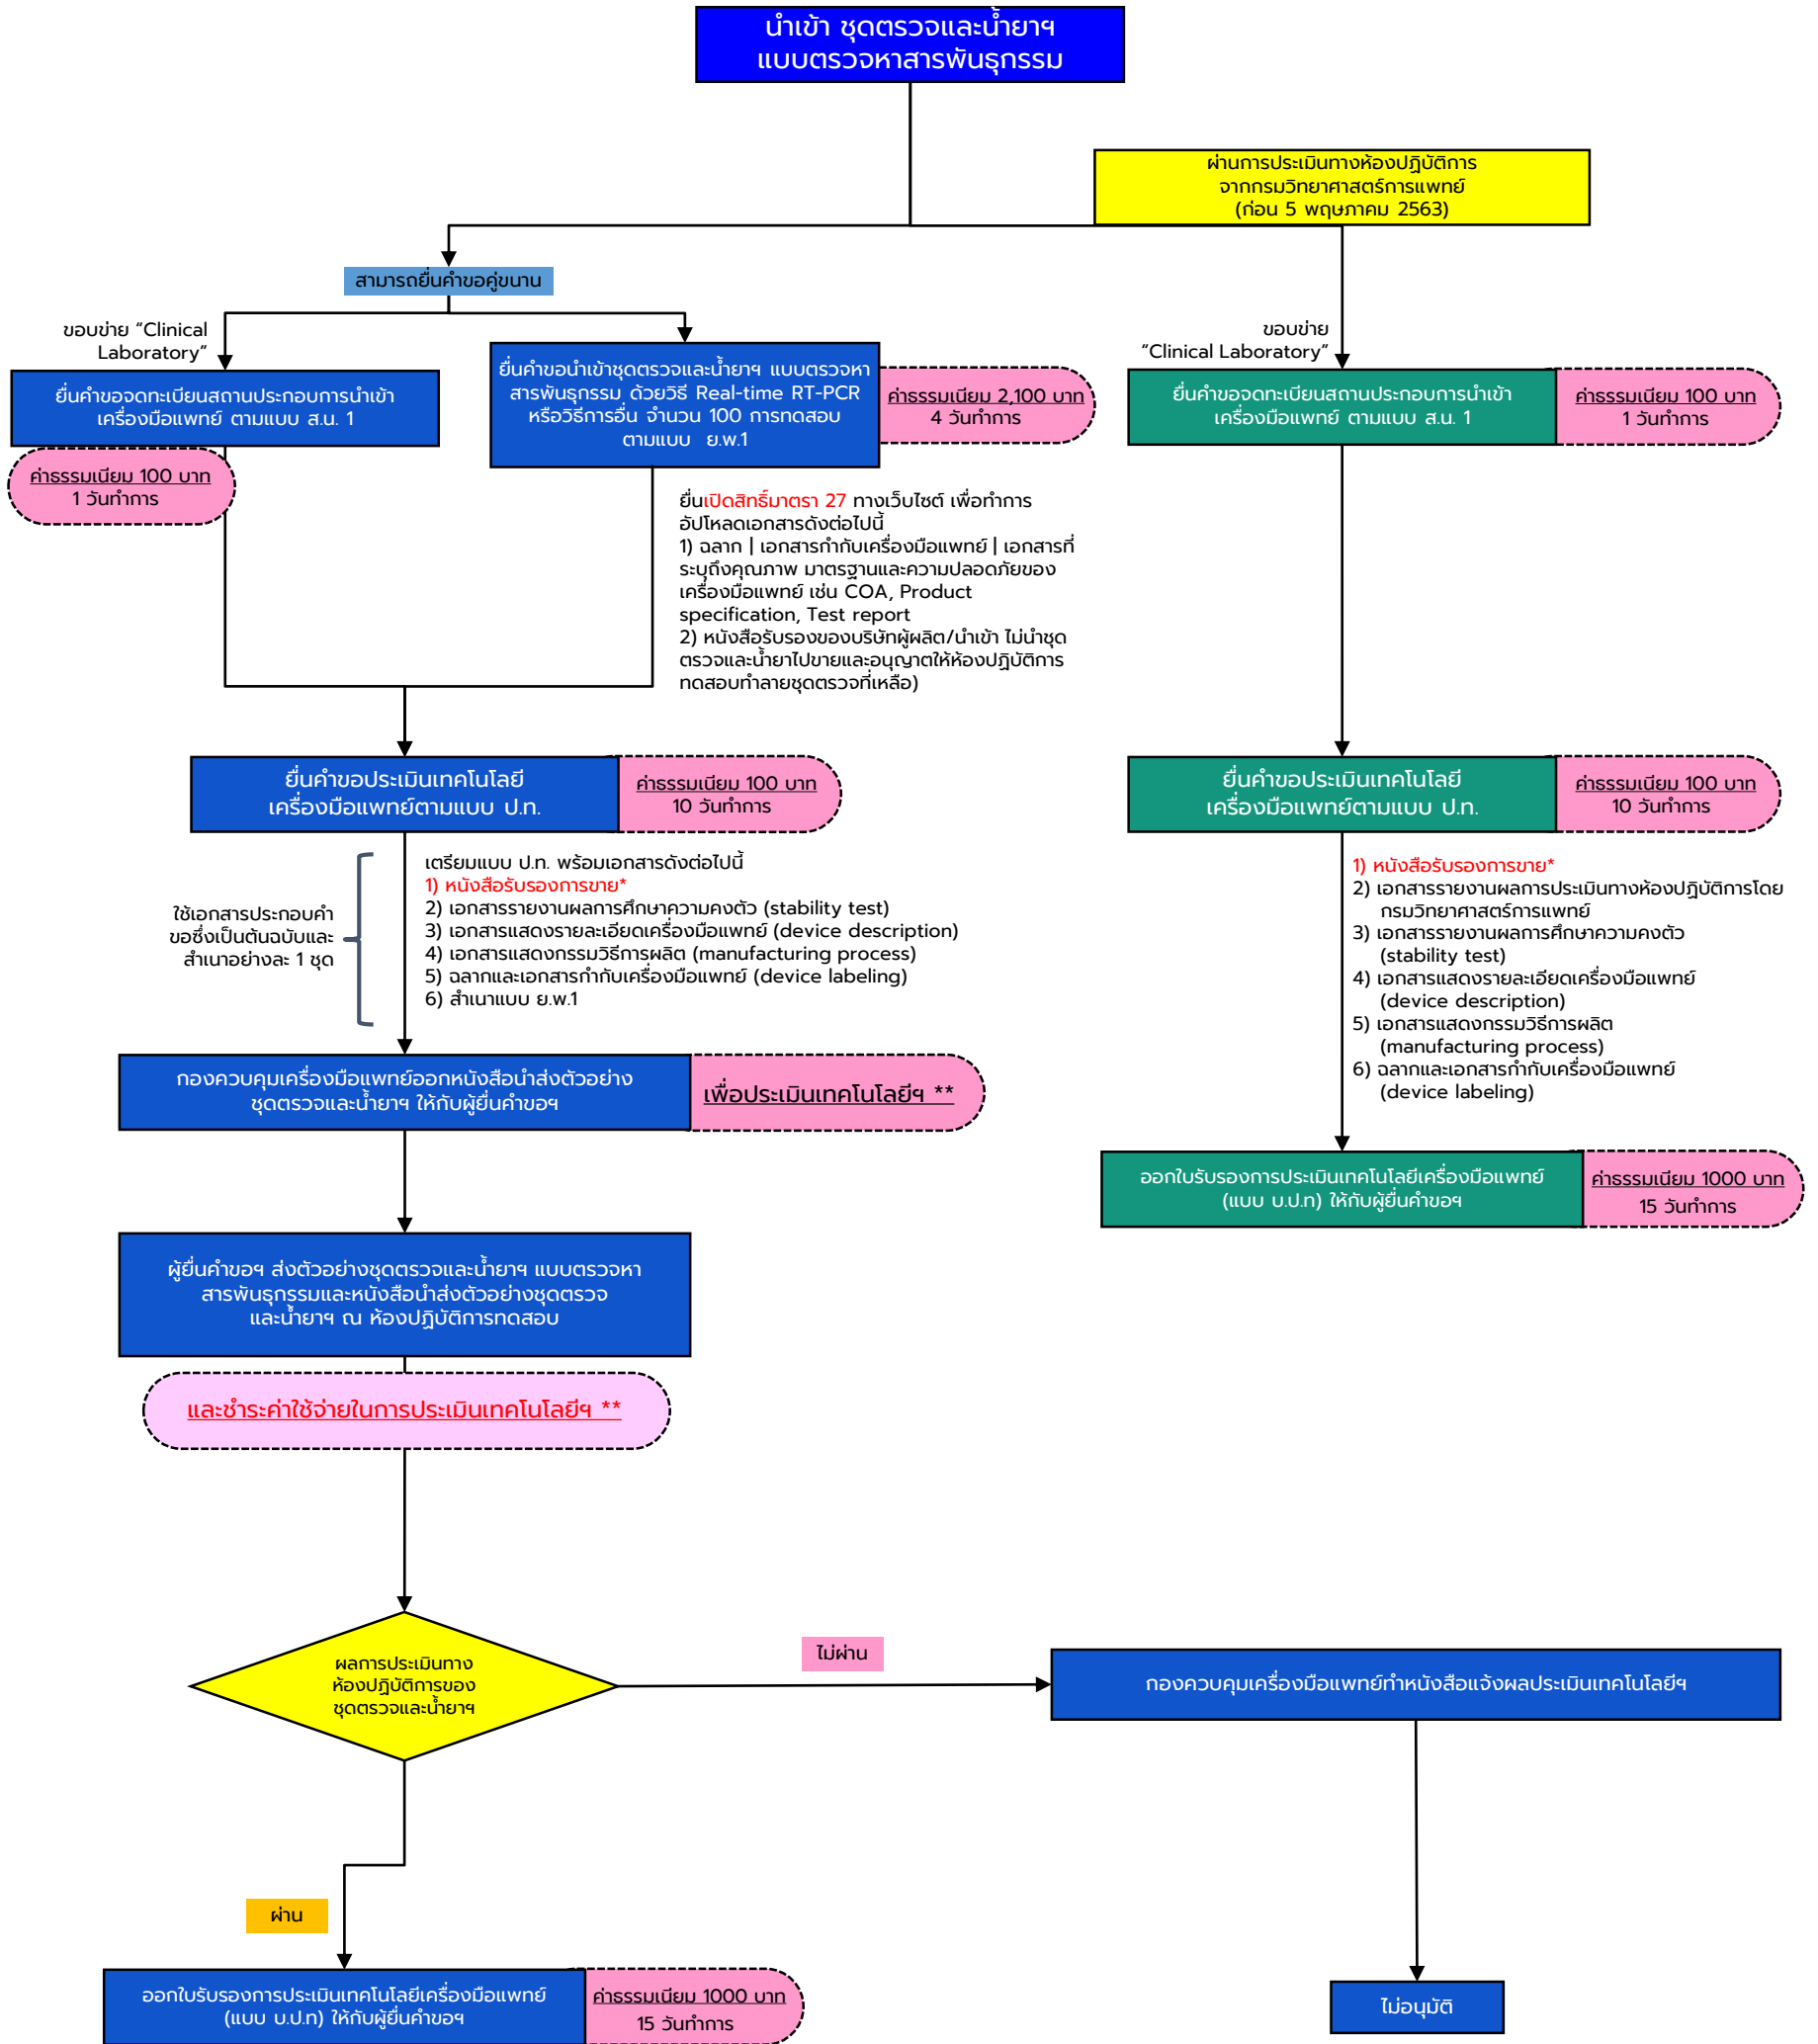


**\*หนังสือรับรองการขาย** สามารถเลือกส่งเอกสารได้ 2 แบบ คือ

- **ต้นฉบับ** ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐจากประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานของรัฐในประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นรับรอง หรือผู้ผลิต หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่ยังไม่หมดอายุ
- **สำเนา** ที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองนั้น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่หน่วยงานของรัฐรับรองหรือพนักงานโนตารีปับลิก (notary public) แทน

**\*\* อัตราค่าใช้จ่ายในการประเมินเทคโนโลยี** ของชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ให้เป็นไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้

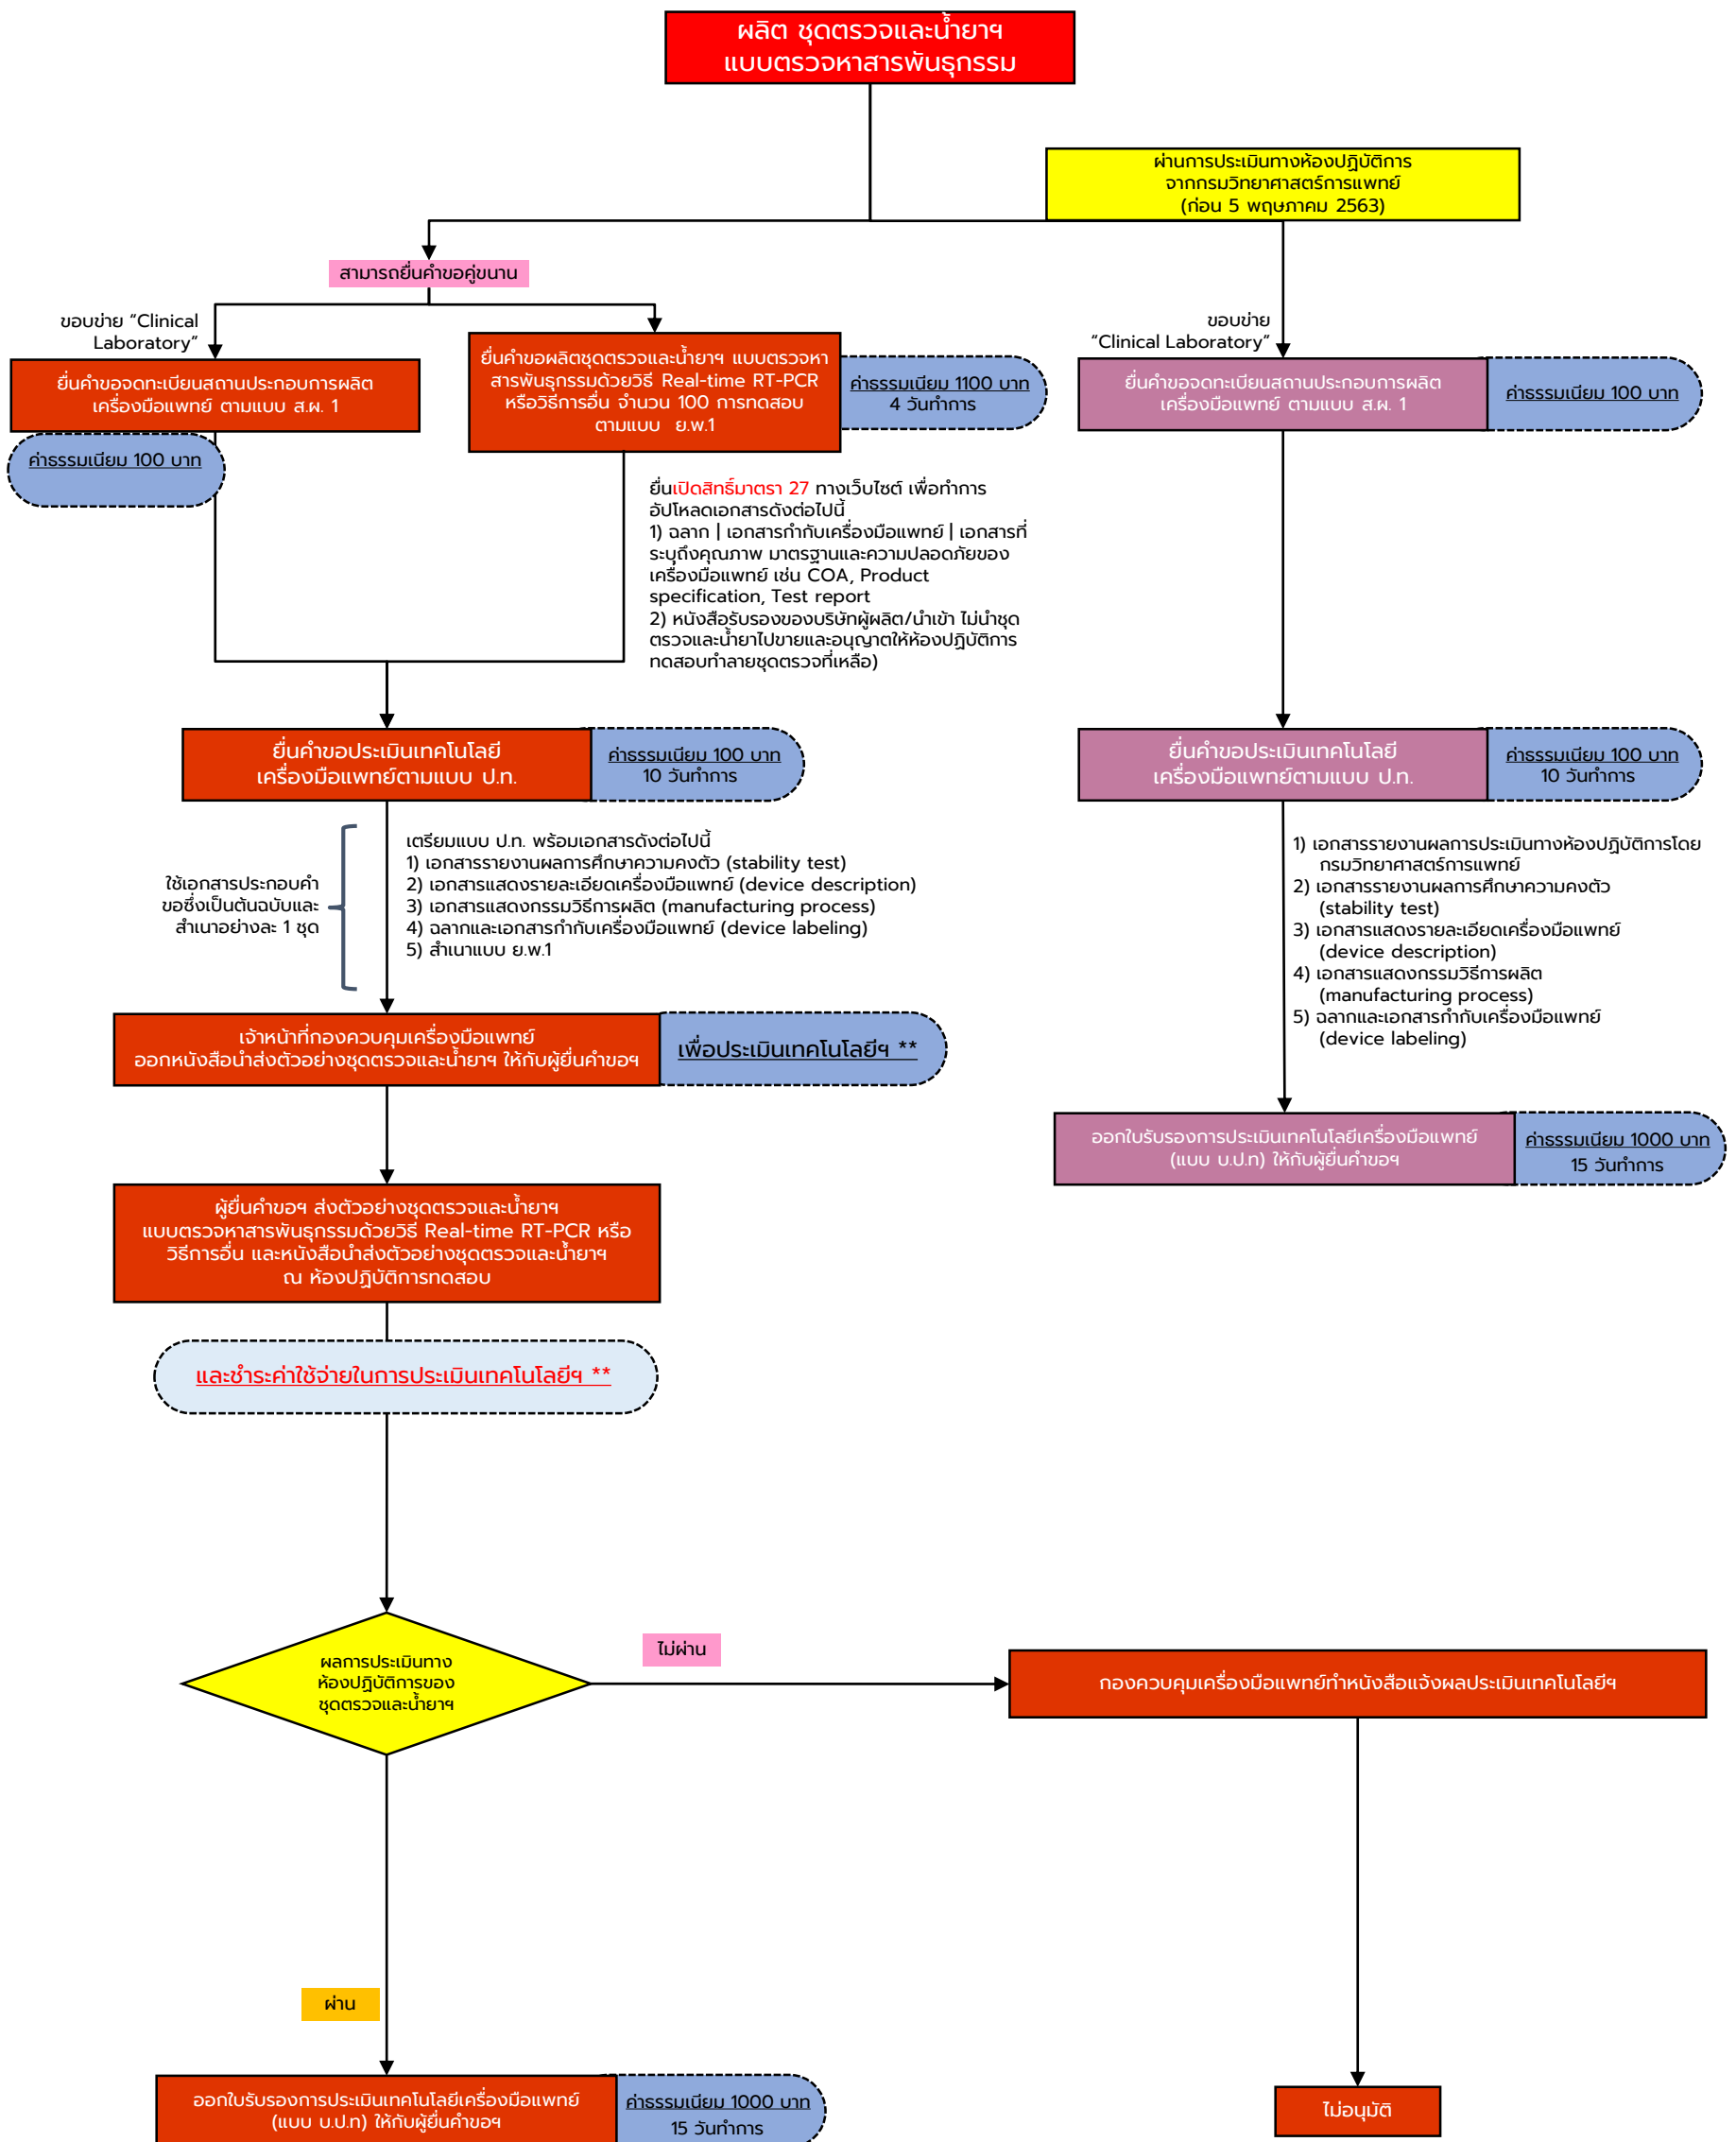


**\*\* อัตราค่าใช้จ่ายในการประเมินเทคโนโลยี** ของชุดตรวจและน้ำยาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ให้เป็นไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้

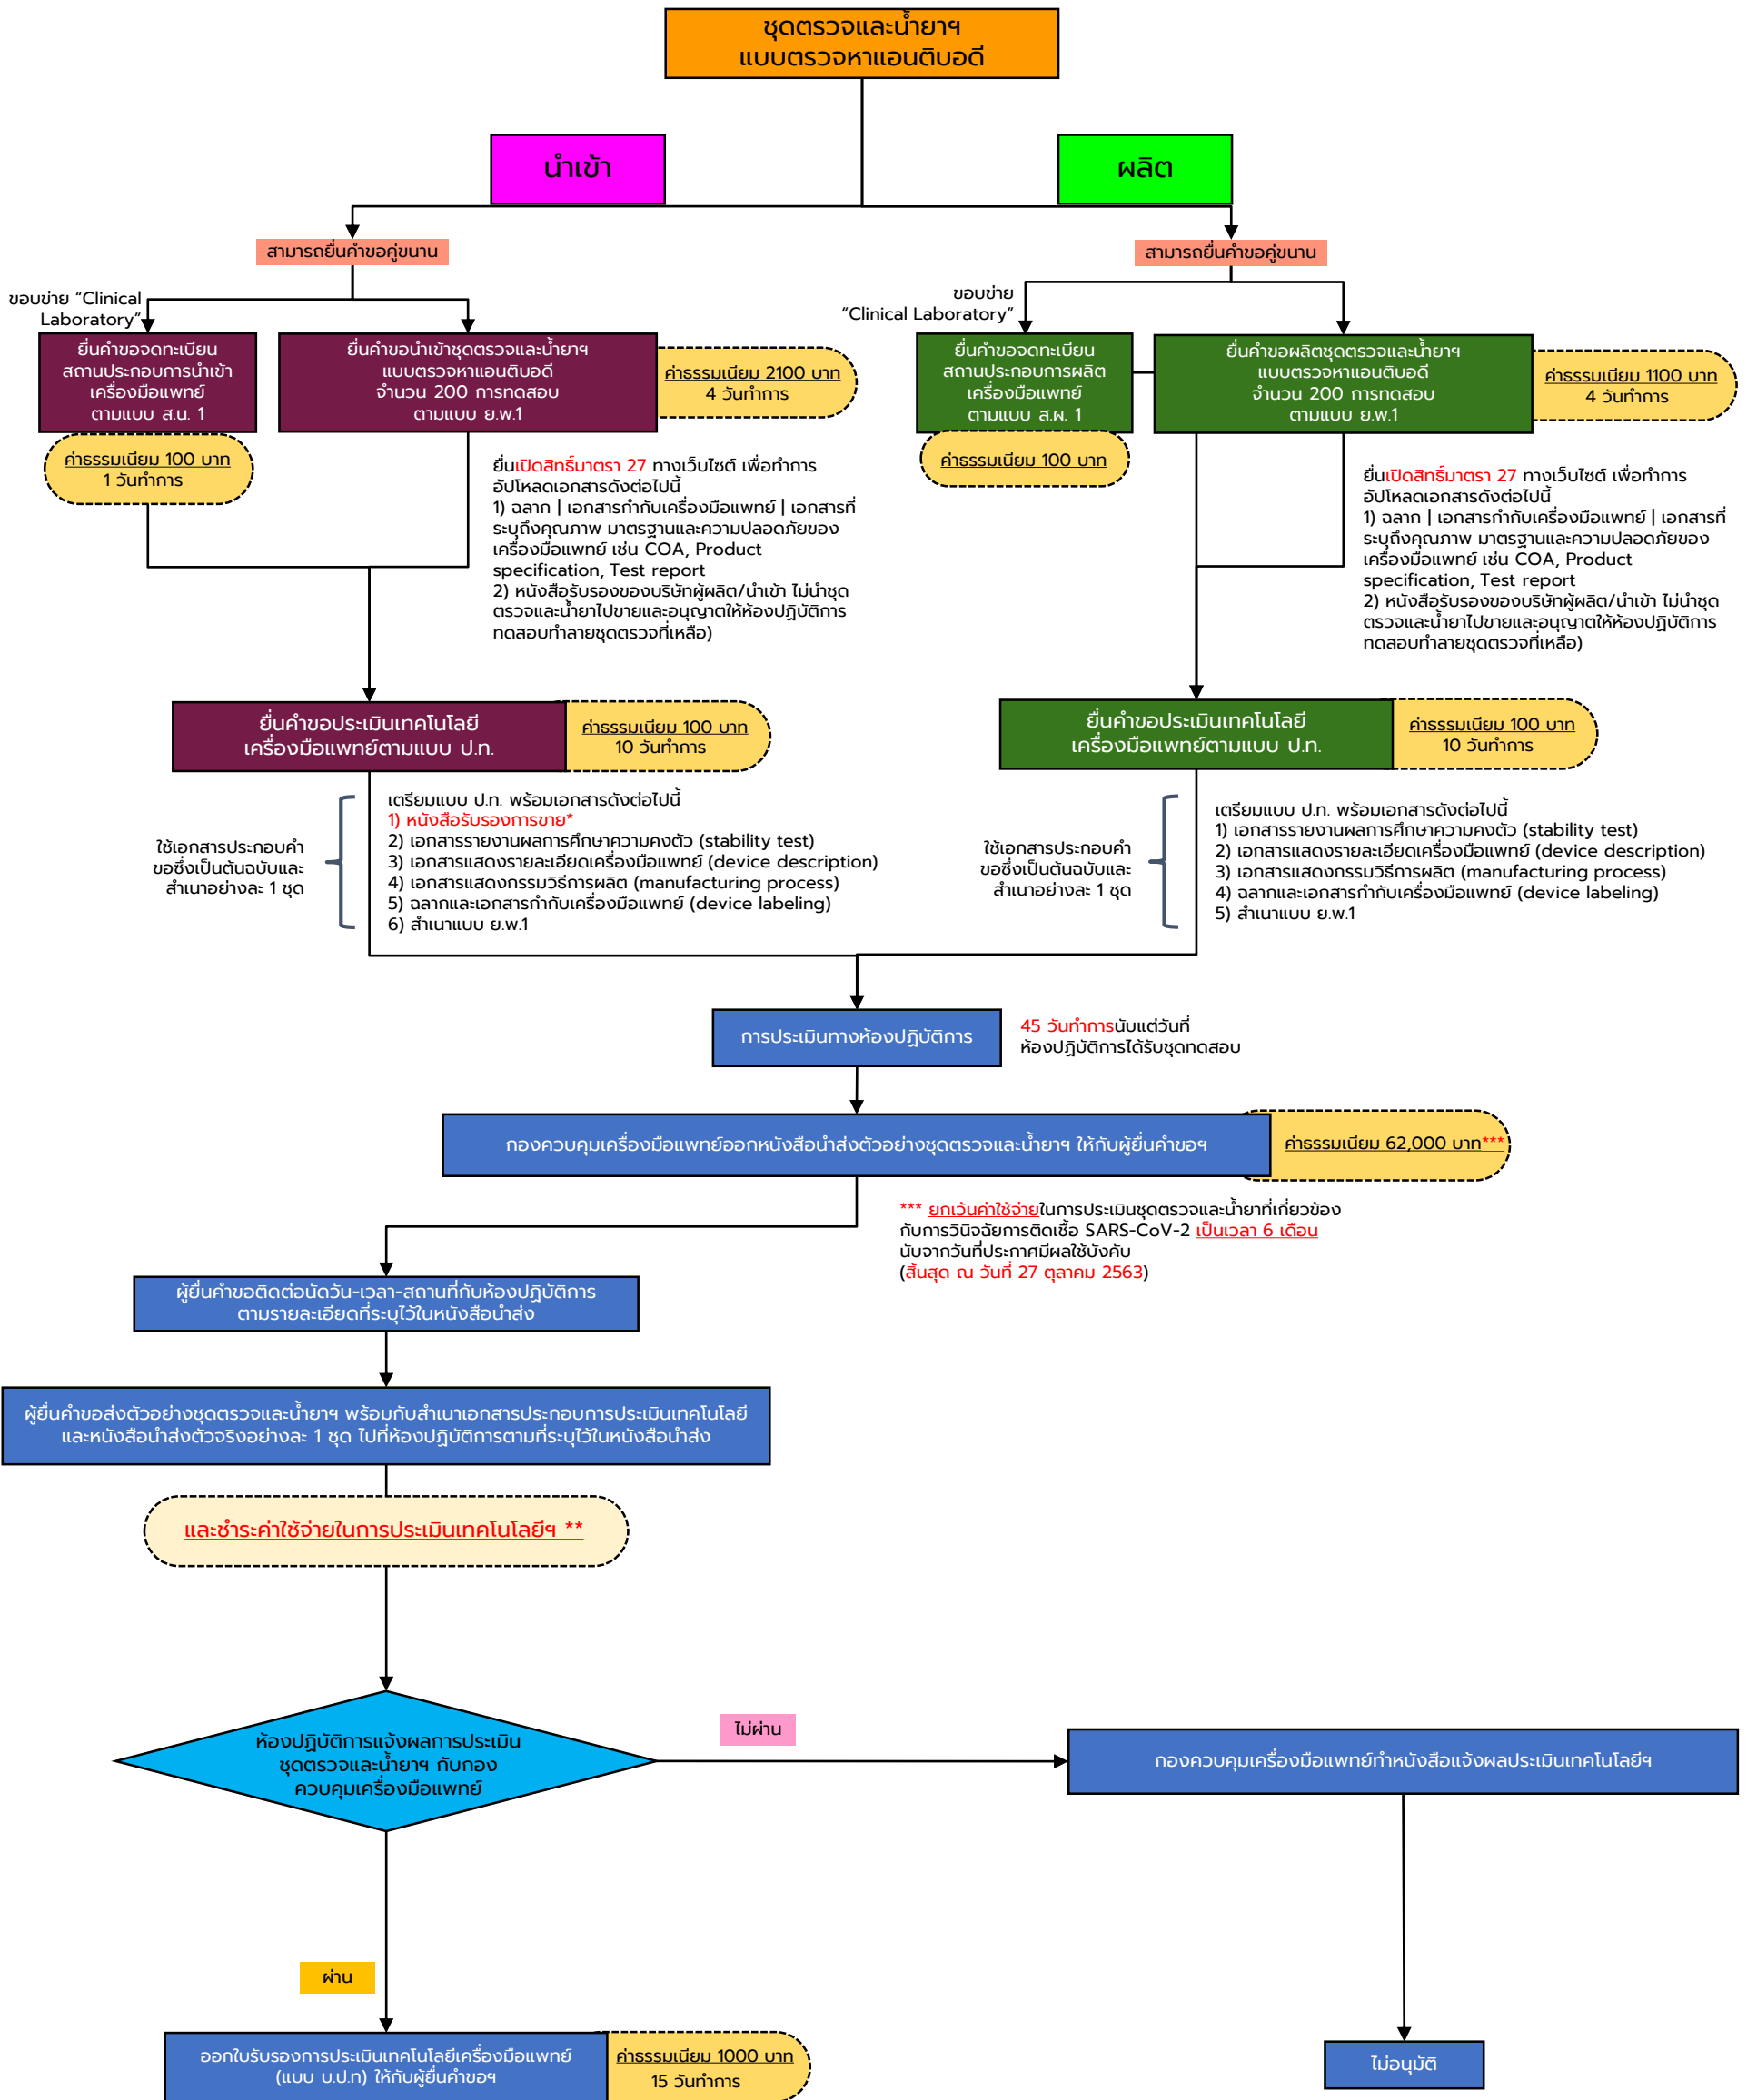

\*หนังสือรับรองการขาย สามารถเลือกส่งเอกสารได้ 2 แบบ คือ

- ต้นฉบับ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐจากประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานของรัฐในประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นรับรอง หรือผู้ผลิต หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่ยังไม่หมดอายุ
- สำเนา ที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองนั้น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่หน่วยงานของรัฐรับรองหรือพนักงานโนตารีปับลิก (notary public) แทน

\*\* อัตราค่าใช้จ่ายในการประเมินเทคโนโลยีของชุดตรวจและน้ำยาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ให้เป็นไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้

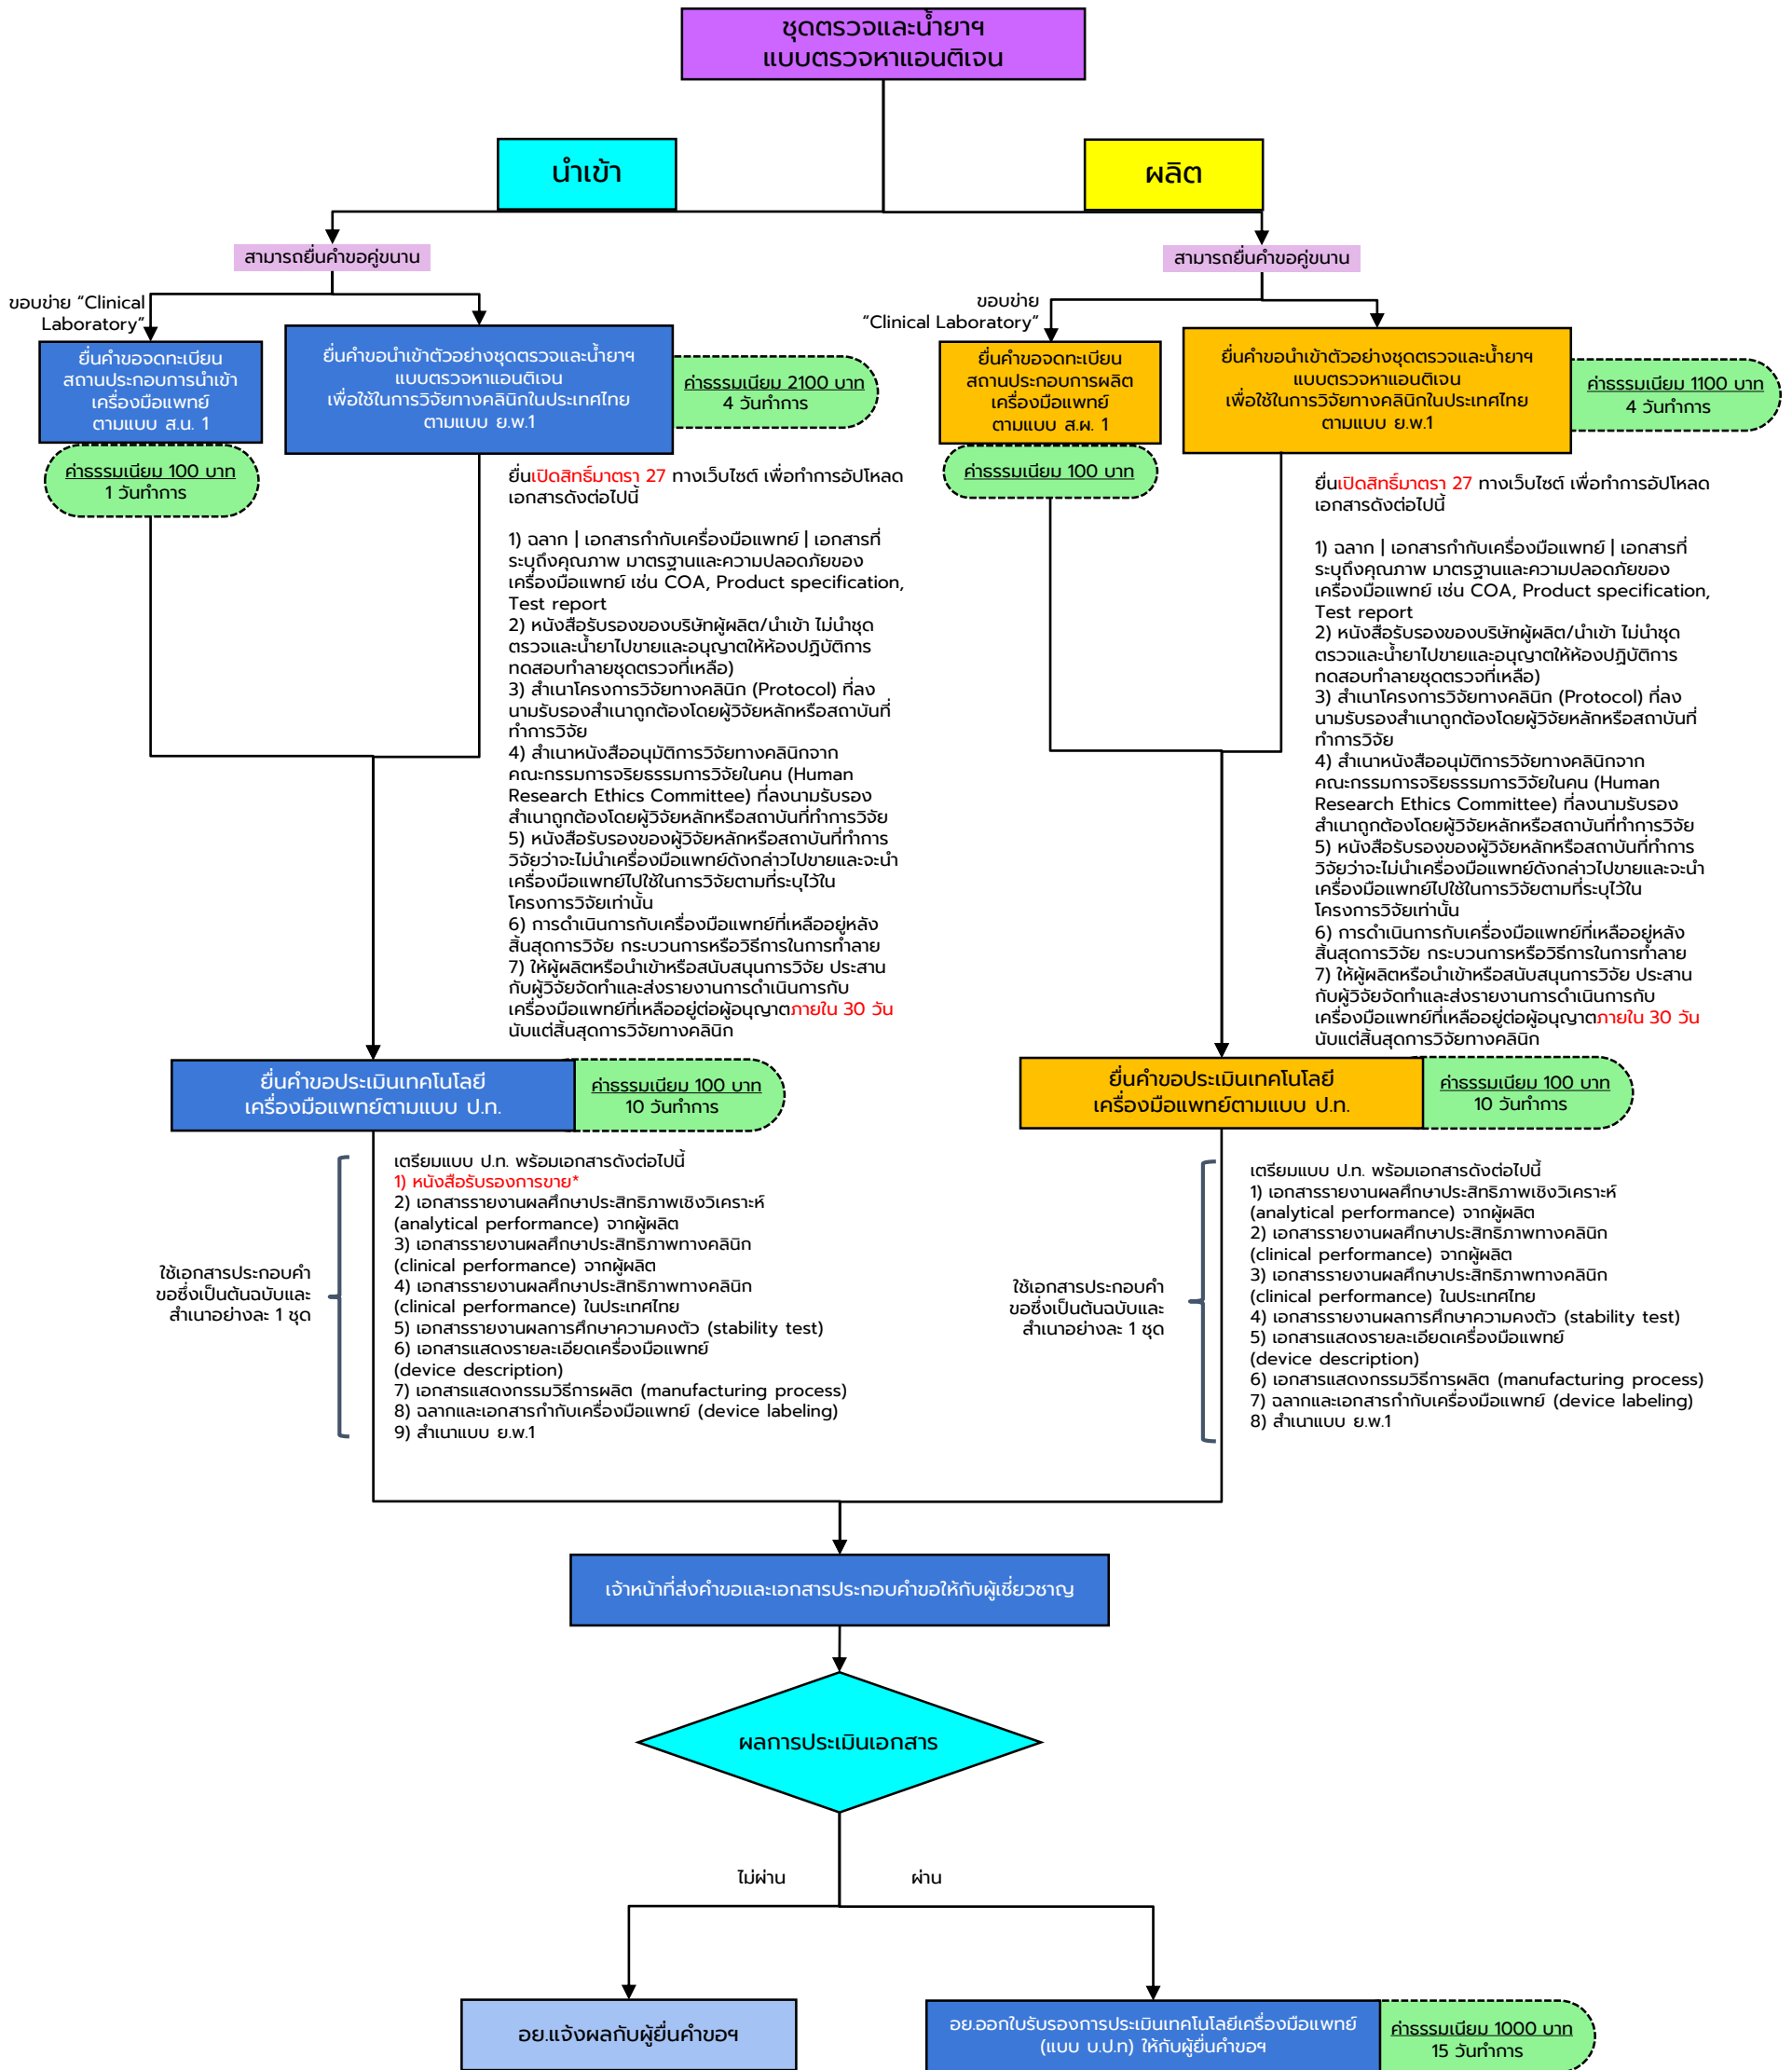

\*หนังสือรับรองการขาย สามารถเลือกส่งเอกสารได้ 2 แบบ คือ

- ต้นฉบับ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐจากประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานของรัฐในประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นรับรอง หรือผู้ผลิต หรือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่ยังไม่หมดอายุ
- สำเนา ที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองนั้น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่หน่วยงานของรัฐรับรองหรือพนักงานโนตารีพับลิก (notary public) แทน

\*\* อัตราค่าใช้จ่ายในการประเมินเทคโนโลยีของชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ให้เป็นไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้